Medtronic

OLULISED SAMMUD

Infusioonikomplekti töökorda seadmine / täitmine (*priming*)

Et vältida võimalikku insuliini ülemanustamist koheselt pärast infusioonikomplekti vahetamist.

On väga oluline järgida alltoodud samme, et vältida vedeliku sattumist infusioonikomplekti membraanile töökorda seadmise ajal:

a) Pärast reservuaari täitmist kontrollige, et insuliiniampull on püstiasendis, kui eemaldate reservuaari sinisest kaitsmest/vahelülist (mille abil tõmmatakse insuliini). Sellega väldite insuliini tahtmatut sattumist reservuaari ülemise osa peale, kust vedelik võib sattuda infusioonikomplekti membraanile.

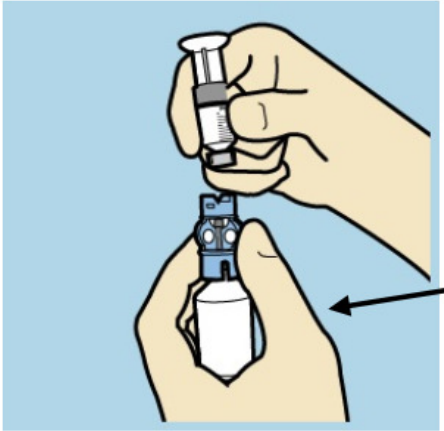

Hoidke insuliiniampull püstiasendis, kui eemaldate reservuaari.

b) Kui vedelik (nagu insuliin, alkohol või vesi) satub reservuaari peale või kateetri/vooliku konnektori sisse, võib see blokeerida infusioonikomplekti membraani. See võib põhjustada insuliinipumba reservuaari kambris ülerõhu infusioonikomplekti töökorda seadmise ajal (prime). See võib omakorda viia insuliini ülemanustamiseni vahetult pärast infusioonikomplekti vahetust. Kui reservuaari peal või kateetri/vooliku konnektori sees on nähtav vedelik, alustage uuesti uue reservuaari ja infusioonikomplektiga.

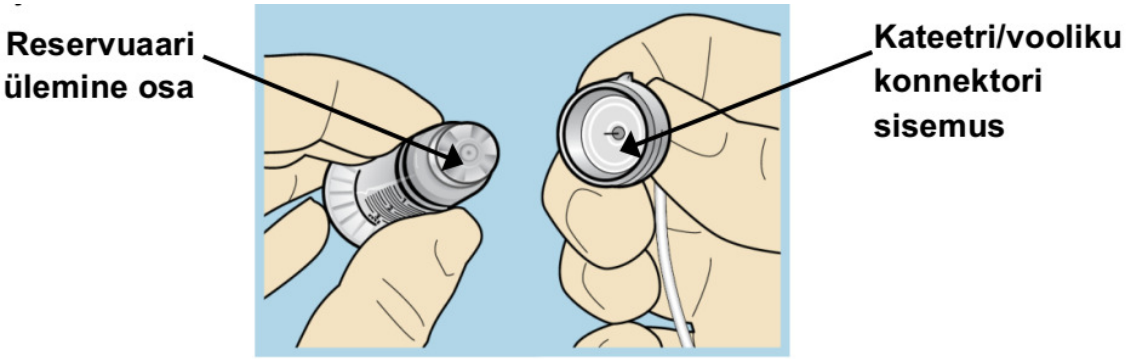

Kontrollige, et need oleksid kuivad, kui ühendate

940M17528-011 20170901 © 2017 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. Third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

Kui märkate pärast töökorda seadmist midagi ebatavalist, nagu insuliini tilkumine või pritsimine infusioonikomplekti kanüülist, siis ärge kanüüli sisestage. Alustage uuesti uue reservuaari ja infusioonikomplektiga.

Soovituslikud toimingud infusioonikomplekti vahetamisel:

- Ärge vahetage oma infusioonikomplekti enne magamaminekut, et saaksite jälgida oma veresuhkru taset.
- Täiendava ettevaatusabinõuna kontrollige oma veresuhkru taset 1 tunni möödumisel pärast infusioonikomplekti vahetust lisaks tavakontrollile.

Järgides ülaltoodud juhiseid saate tuvastada võimaliku hüpoglükeemia ja hüperglükeemia, et saaksite koheselt võtta kasutusele vajalikud meetmed.

Kui kõik Teil olemasolevad infusioonikomplektid on käesoleva ohuteate raames tagasikutsutud, kuid Te soovite neid ikkagi kasutada enne asendustoodete saabumist, soovitame Teil olla hoolikas ja JÄRGIDA ÜLALTOODUD OLULISI SAMME tööökorda seadmisel/täitmisel (*priming*).

940M17528-011 20170901 © 2017 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. Third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company